

Новый отчет

Фирма


Заказчик

Контролер

Прибор testo 875-2


Серийный №: 1898954

Заказ

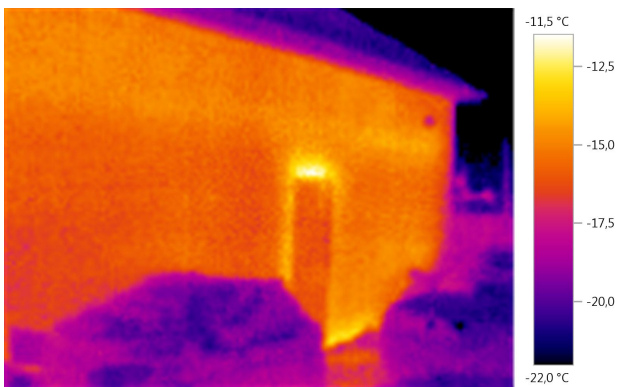


Графические данные: Дата: 11.02.2012
Время: 17:38:12
Файл: IV_01584.BMT

Коэффициент излучения: 0,93
Отраж. темп. [°C]: 20,0

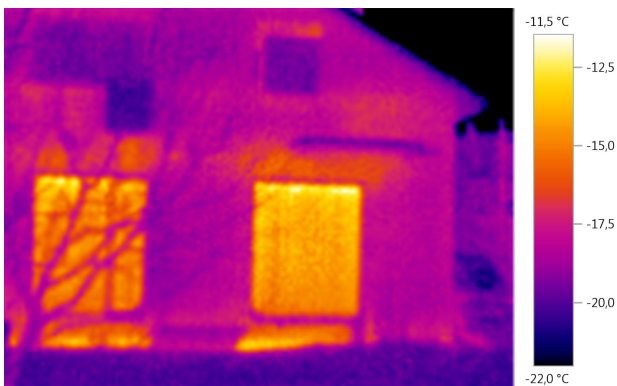


Графические данные: Дата: 11.02.2012
Время: 17:40:04
Файл: IV_01590.BMT

Коэффициент излучения: 0,93
Отраж. темп. [°C]: 20,0

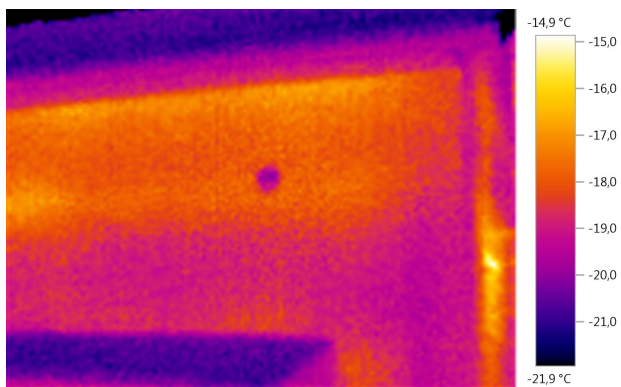


Графические данные: Дата: 11.02.2012
Время: 17:40:54
Файл: IV_01593.BMT

Коэффициент излучения: 0,93
Отраж. темп. [°C]: 20,0

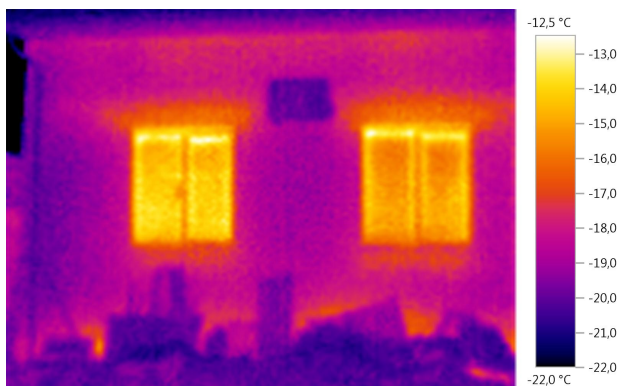

Графические данные: Дата: 11.02.2012
Время: 17:41:58
Файл: IV_01595.BMT

Коэффициент излучения: 0,93
Отраж. темп. [°C]: 20,0

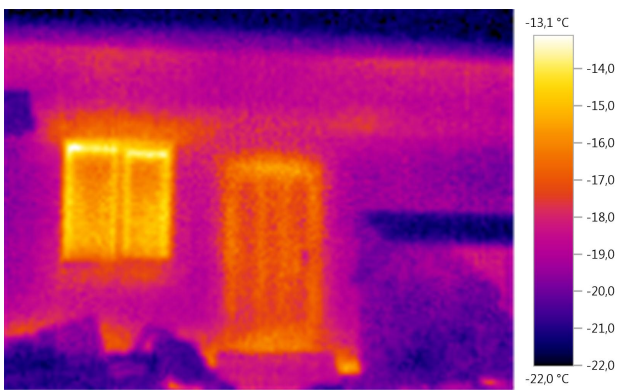

Графические данные: Дата: 11.02.2012
Время: 17:42:27
Файл: IV_01596.BMT

Коэффициент излучения: 0,93
Отраж. темп. [°C]: 20,0

13.02.2012 , _____